

# 荣耀 Earbuds 3 Pro

用户手册

HONOR

# 目录

## 认识耳机

外观结构	1
指示灯	1
拿取耳机	2
更换耳套	3
充电续航	3

## 快捷操作

快捷操作说明	5
修改快捷操作	5

## 配对连接

蓝牙配对	6
靠近发现	6
双设备连接	7
自动回连	7

## 日常操作

噪声控制	8
体温测量	8
修改耳机名称	9
下载安装 App	9
智能佩戴检测	10


## 更多设置

智慧升级	11
清洁保养	11
佩戴健康	12

# 认识耳机

## 外观结构

### 外观示意图

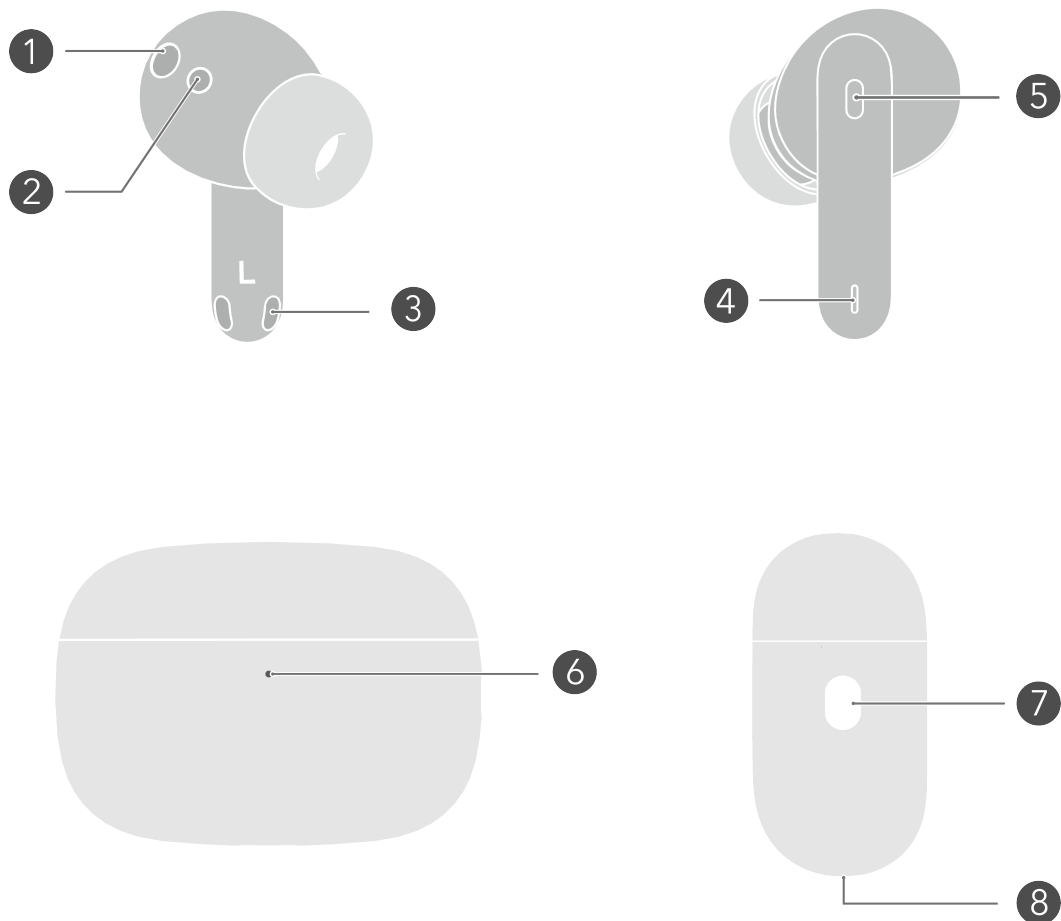

- ① 泄音孔
- ② 温感器
- ③ 充电PAD
- ④ 主MIC孔

- ⑤ 副MIC孔
- ⑥ 指示灯
- ⑦ 功能键
- ⑧ USB-C接口

## 指示灯

### 指示灯状态说明

您可以通过指示灯状态来判断耳机和充电盒的电量。

充电盒有一个盒外指示灯，单耳机在盒内显示盒内耳机电量，双耳机在盒内显示最小电量耳机的电量，耳机不在盒内显示充电盒电量。


操作状态	指示灯显示状态
------	---------

充电盒充电	绿灯常亮： 充电盒充电中（电量 $\geq$ 约90%）
	黄灯常亮： 充电盒充电中（电量 $<$ 约90%）
	灭灯： 拔掉充电器的同时，指示灯会熄灭
打开充电盒盖	绿灯亮 10 秒后熄灭： 电量充足（ $\geq$ 约60%）
	黄灯亮 10 秒后熄灭： 电量适中（约20% $\leq$ 电量 $<$ 约60%）
	红灯亮 10 秒后熄灭： 警示电量（ $<$ 约20%）
	不亮： 充电盒电量耗尽
按住功能键	白灯闪烁： 耳机在盒内，按键 2 秒进入配对状态
	红灯闪烁： 耳机在盒内，按键 6 秒进入恢复出厂设置

## 拿取耳机

### 拿取耳机说明

食指抵进凹槽，弯曲指腹贴紧耳包，向外推动，拇指辅助提起耳机。

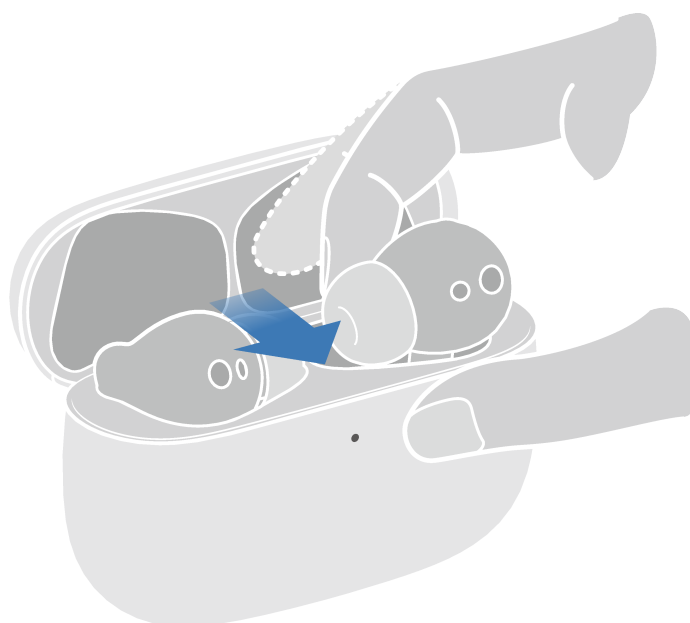


## 更换耳套

### 更换耳套说明

请您根据降噪效果及舒适度为左右耳更换不同的耳塞套：

- 1 左右手分别捏住耳机头和耳套，同时轻轻用力向外分离将耳套取下；
- 2 使用棉签或干净的软毛刷清理耳机头钢网部分的灰尘及耳垢；
- 3 耳套内部凹处对准耳机出音嘴上下凸起部位，按照下图所示方向，用力推进安装。

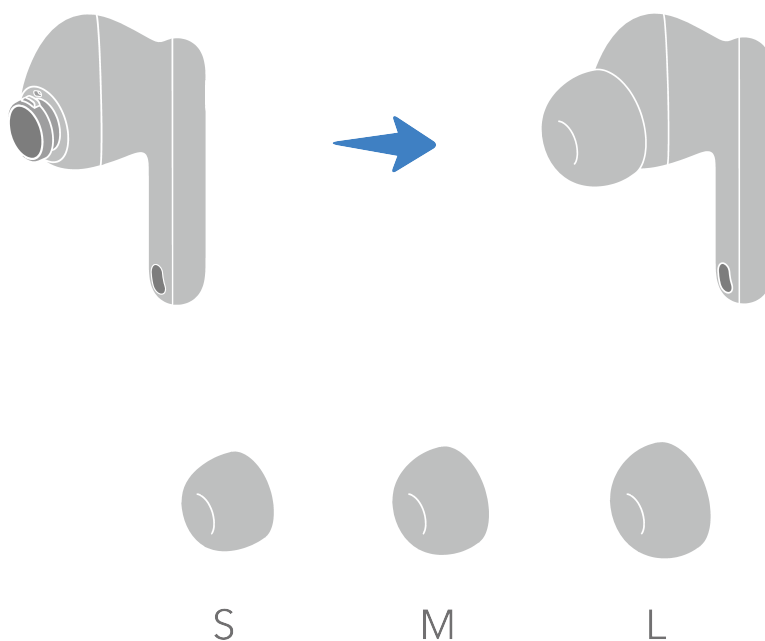

## 充电续航

### 给充电盒充电


使用 USB-C 充电线为充电盒充电，或将充电盒指示灯朝上放置在兼容的无线充电器上进行充电。



- i 充电盒充电时，盒外指示灯常亮即表明可正常充电。
  - 如果想获得最佳无线充电效率，请将充电盒背面下半部（无线充电效率最高点）对准无线充电器中心进行充电，若放置偏位，可能会导致无法正常充电，影响充电效率。
  - 无线充电时，如果出现指示灯异常闪烁或灭灯等情况，请重新调整充电盒位置直至指示灯常亮。
  - 为保证充电效果及安全，请选择正规品牌充电器和充电线。

### 给耳机充电

将耳机放入充电盒，**关盖后**充电盒自动为耳机充电。

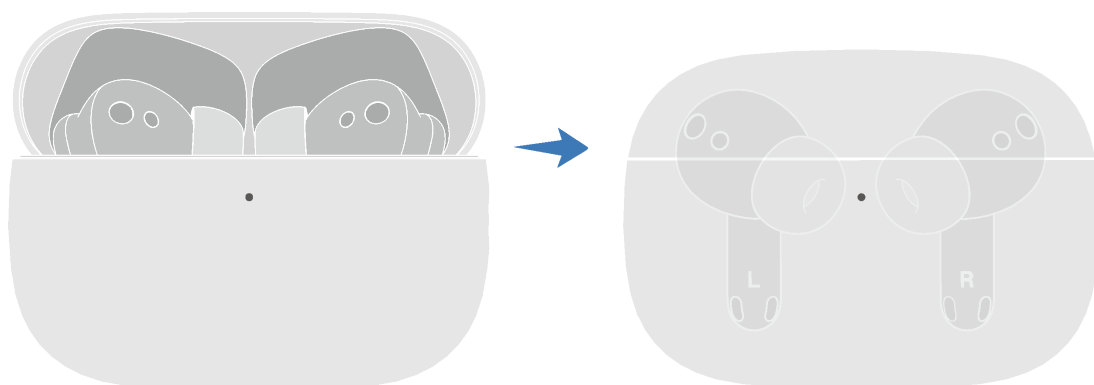








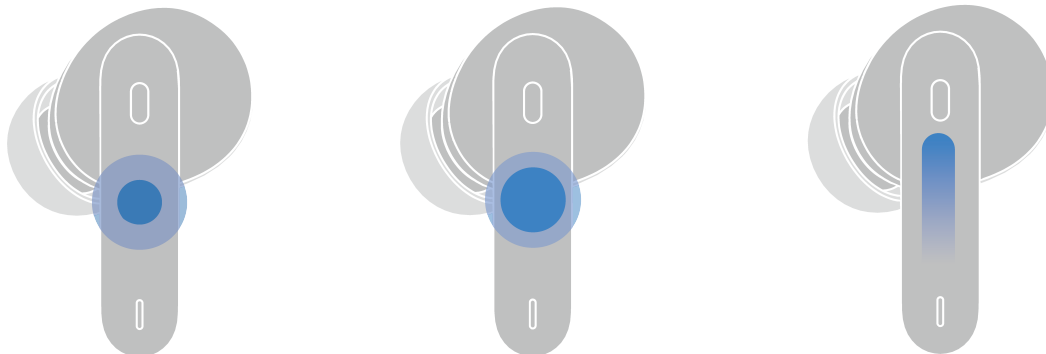

- i 开盖时，充电盒不给耳机充电。

# 快捷操作

## 快捷操作说明

### 控制耳机




-  轻点两下：播放/暂停音乐
-  轻点两下：接听/结束通话
-  轻点三下：测量体温
-  按住：拒接电话
-  按住：切换噪声控制模式
-  向上轻滑：调大音量
-  向下轻滑：调小音量
-  您还可以根据自身需求，在**荣耀智慧空间** App 中自定义快捷操作。

## 修改快捷操作

### 修改快捷操作手势：

耳机连接手机/平板后，您可以通过以下两种方式修改快捷操作手势：

**方式一：**打开手机/平板（Magic UI 4.0 及以上版本），进入 **设置 > 蓝牙 > 已配对的设备**，点击对应耳机蓝牙名称右侧  按钮，选择 **快捷操作** 来进行修改。

**方式二：**打开**荣耀智慧空间** App，进入耳机详情页，选择 **快捷操作** 来进行修改。

# 配对连接

## 蓝牙配对

### 配对连接示意

耳机入盒并保持盒盖打开状态，按住功能键 2 秒，指示灯白灯闪烁，耳机进入配对状态。

**i** 首次打开盒盖，耳机自动进入配对状态。



**i** **恢复出厂设置**：耳机入盒并保持盒盖打开状态，长按功能键 6 秒，指示灯红灯闪烁后，耳机恢复出厂设置并重新进入配对状态。

## 靠近发现

### 靠近发现弹窗连接

耳机搭配部分手机/平板（Magic UI 4.0 及以上版本）在屏幕解锁后，支持靠近发现弹窗配对连接、查看电量功能。

- 1 开启手机/平板蓝牙开关；
- 2 耳机首次使用开机/开盖，或设置耳机进入配对状态；
- 3 耳机保持盒盖打开状态，靠近手机/平板会出现连接弹窗，根据界面提示完成配对连接。


**i** 耳机保持盒盖打开状态，靠近已配对过的设备会自动回连，回连成功后设备弹出电量显示界面。



## 双设备连接

### 开启双设备连接功能


耳机与手机/平板连接后，您可以通过以下两种方式来开启双设备连接功能：

**方式一：**打开手机/平板（Magic UI 6.0 及以上版本），进入 **设置 > 蓝牙 > 已配对的设备**，点击对应耳机蓝牙名称右侧  按钮，选择 **更多设置**，开启 **双设备连接**。

**方式二：**耳机和荣耀智慧空间 App 均升到最新版本后，打开App 进入耳机详情页，打开 **双设备连接** 页面，开启 **双设备连接**。

### 连接步骤

- 1 开启双设备连接功能后，耳机入盒并开盖，长按功能键 2 秒至白灯闪烁，进入配对状态，使用设备A搜索耳机名称进行配对；
- 2 保持耳机入盒并开盖，再次长按功能键 2 秒至白灯闪烁，进入配对状态，使用设备B搜索耳机名称进行配对；
- 3 设备B与耳机连接成功后，耳机会自动回连设备A，此时耳机同时连接两个设备。

 若手表已连接其他设备，耳机将无法同时连接手表。

## 自动回连

### 自动回连说明

耳机在空旷无干扰的环境下，耳机音乐和通话状态有效使用距离可达 10 米。

当超出有效使用距离以后，耳机会卡顿，无声，甚至会自动断开连接。耳机在要求时间内回到有效使用距离（10 米）后自动恢复连接；若耳机无法自动回连，请重启手机/平板端蓝牙，重新进行配对连接。

# 日常操作


## 噪声控制


### 切换噪声控制模式

耳机与手机/平板连接后，您可以通过以下三种方式来进行噪声控制：

**方式一：**按住左/右耳机，开启或关闭降噪、透传功能，根据语音提示切换噪声控制模式。

**方式二：**打开荣耀智慧空间 App，进入耳机详情页，选择 **噪声控制**，开启或关闭 **降噪、透传** 功能。

**方式三：**打开手机/平板（Magic UI 6.0 及以上版本），进入 **设置 > 蓝牙 > 已配对的设备**，点击对应耳机蓝牙名称右侧  按钮，选择 **噪声控制**，开启或关闭 **降噪、透传** 功能。


-  建议使用尺寸合适的耳塞并调整佩戴姿势，配合耳塞贴合检测以确保耳塞紧密贴合耳道，可让您获得较好的音质和优越的降噪体验。
- 单只耳机使用时也具有降噪功能，但使用单只耳机时另外一只耳朵暴露在环境中，此时您实际上对单只耳机降噪的效果感知有限，双耳机佩戴使用场景更为普遍。若想获得更好的降噪体验，建议您佩戴两只耳机使用。
- 开始单耳佩戴时，会自动转为 **关闭** 模式，当单耳佩戴再设置为降噪或透传模式时，不会保存状态，重新双耳佩戴时会自动恢复到上一次设置的模式。


## 体温测量

### 单次测量

耳机与手机/平板连接后，耳机保持佩戴状态，您可以通过以下两种方式进行单次体温测量，实时获取体温信息：

**方式一：**轻点三下左/右耳机，开始测温，耳机侧语音播报体温信息。

**方式二：**打开荣耀智慧空间 App，登录荣耀帐号，进入耳机详情页，点击体温测量图标 ，开始测温，耳机侧语音播报体温信息。

-  在通话中或语音助手唤醒后，可以轻点三下进行测温，耳机侧不会语音播报体温信息，您可以通过荣耀智慧空间 App 来查看体温信息。

### 周期测量

耳机与手机/平板连接后，打开荣耀智慧空间 App，登录荣耀帐号，进入耳机详情页，开启周期测量功能，查看最近体温趋势卡片。

您还可以通过以下两种方式开启周期测量功能：

**方式一：**点击 **设置 > 体温监测**，开启 **周期测量** 功能。

**方式二：**打开 **体温** 页面，点击 **体温监测**，开启 **周期测量** 功能。

**i** 在**体温**页面，可以根据时、日、周、月来查看历史体温数据，点击**查看统计详情**，可以查看全部体温数据，支持批量删除体温数据或长按删除单日体温数据。

## 高低温提醒


在**体温监测**页面，开启**周期测量**功能后，您可以开启或关闭**周期测量异常提醒**，自定义设置**体温过高提醒**和**体温过低提醒**温度值。


- i** · 测量时，请佩戴好耳机，保持 5 分钟后再启动测量，请确保耳机接触处没有水渍、酒精等液体。
- 运动、洗澡、室内室外环境切换时，请等待 30 分钟后进行测量。
- 如果想要获取更加准确的测量数据，建议您佩戴好耳机后，保持 10 分钟以上，在室温 25°C 左右的环境下测量，避免在阳光直射、有风、有冷热源的环境下进行测量。
- 本产品非医疗器械，为预期用于健康人群、以健康管理为目的、记录健康信息的移动设备。测温功能主要用于18岁以上人群查看耳部温度及变化，所提供的健康数据及建议仅供参考，测试数据和结果不作为医疗诊断用途，如有身体不适，请及时就医。

## 修改耳机名称

### 修改耳机名称：

耳机与手机/平板为连接状态时，您可以通过以下两种方式来修改耳机名称：

**方式一：**打开荣耀手机/平板，进入**设置 > 蓝牙 > 已配对的设备**，点击对应耳机名称右侧  按钮，按照界面提示修改耳机名称。

**方式二：**打开荣耀智慧空间 App，进入耳机详情页，点击右上角  图标，进入**设备设置 > 设备名称**，按照界面提示修改耳机名称。

## 下载安装 App

### 下载荣耀智慧空间 App

扫描二维码下载并安装荣耀智慧空间 App，获取更多功能及自定义设置，获得更好的聆听体验。



### 通过荣耀智慧空间 App 添加耳机

通过荣耀手机/平板中的荣耀智慧空间 App，您可以按照以下步骤进行添加或连接耳机：

- 1 点击荣耀智慧空间 App 首页右上角 + > 添加设备，设置耳机进入配对模式，将耳机靠近手机进行扫描；
- 2 App 自动发现耳机后点击 连接 按钮，并根据界面提示，完成添加；
- 3 耳机添加至 App 后，生成耳机详情页，可进行功能设置、固件更新等操作。


## 智能佩戴检测

### 智能佩戴检测说明

手机/平板智能检测耳机的佩戴状态，进行音乐自动暂停播放或通话音频自动切换。

耳机与手机/平板连接后，您可以通过以下两种方式开启或关闭智能佩戴检测功能：

**方式一：**打开荣耀智慧空间 App，进入耳机详情页，点击 设置，开启或关闭 智能佩戴检测 。

**方式二：**打开荣耀手机/平板，进入 设置 > 蓝牙 > 已配对的设备，点击对应耳机蓝牙名称右侧  按钮，进入 更多设置，开启或关闭 智能佩戴检测 。

# 更多设置

## 智慧升级


### 更新升级


耳机与手机/平板连接后，您可以通过以下两种方式进行升级：

**方式一：**通过荣耀智慧空间 App 升级。

- 1 打开荣耀智慧空间 App，进入耳机详情页；
- 2 选择最下方的 **固件更新**，点击 **检查更新**。当提示有新版本时，可以点击 **下载并安装**，并根据界面提示，完成升级。

**方式二：**通过音频产品管家升级。

- 1 打开荣耀手机/平板，进入 **设置 > 蓝牙 > 已配对的设备**，点击对应耳机名称后面的 ，进入音频产品管家页面；
- 2 选择最下方的 **固件更新**，点击 **检查更新**。当提示有新版本时，可以点击 **下载并安装**，并根据界面提示，完成升级。

-  升级前需确保耳机及充电盒电量均 $\geq 20\%$ ，并保持耳机在盒开盖状态，升级过程请勿操作耳机。升级启动后（比如升级进度条到2%以上），充电盒关盖不会影响升级过程。
- 升级完成后，需要进行开关盖操作，耳机回连手机/平板。


## 清洁保养

### 清洁和保养耳机

为了获得更好的产品性能（如音质、降噪及通话等体验），预防耳道过敏等问题，建议您定期（1周/次）清洁和保养耳机。


您可以使用酒精或消毒湿巾等对无线耳机外表面进行擦拭，请勿使用这类湿巾擦拭耳机耳塞、耳罩、充电触点或接口、扬声器网罩、泄音孔、麦克风孔等部位，防止耳机受潮或进水。

### 清洁充电盒、充电接口及充电触点：

- 使用柔软干燥的软布来清洁充电盒。如有必要您也可以使用含70%酒精的湿巾擦拭充电盒外部表面，确保充电盒自然晾干后，再将耳机放回盒内。
- 使用干净、干燥的软毛小刷子清洁充电接口的任何碎屑。
- 使用干净、干燥的尖头棉签轻轻擦拭充电盒的充电触点表面。
- 请勿使用浸水的湿布擦拭，擦拭过程不要过度用力，以免造成充电盒内充电柱接触点变形或表面损伤。
-  耳机接触了汗水、沐浴露、洗发水等液体，或佩戴耳机运动后，请确保耳机表面及充电触点洁净干燥后再将耳机放入充电盒充电。

**清洁出声孔、泄声孔及麦克风孔：**使用干净、干燥的尖头棉签将出声孔的脏污及耳垢轻轻刷出，再用软布擦拭干净。

### 清洁耳塞：

- 将耳塞从耳机取下，用清水冲洗/不含酒精的湿巾擦拭。请勿使用肥皂或其他家用清洁剂。
  - 用干净、干燥的软布将耳塞擦干，待完全干燥后，将耳塞装回耳机上。
-  由于含酒精的湿巾刺激性较强，请勿使用含酒精的湿巾擦拭耳塞。

## 佩戴健康

### 健康使用和佩戴耳机

耳机都需要与您的皮肤保持亲密接触，正确、贴合地使用和佩戴，不仅会令您感到更加舒适，而且会让音质、降噪等声学效果最佳。

- 若耳机标配有多种尺寸的耳帽或一体化耳撑，可以选择适合的耳帽使用。如果出现单耳佩戴不牢，也可以左右耳使用不同耳帽组合使用。
- 长时间高分贝音量使用耳机可能会对您的听力造成损伤，建议您每次使用耳机的时间不超过60分钟，音量不超过最大值的60%；睡觉时请取下耳机。
- 如果耳机表面附着有汗水、肥皂水、护肤品等可能会刺激皮肤，建议您保持无线耳机及皮肤的干燥洁净，防止对耳机造成长期损伤。
- 尽量不要与他人交叉使用耳机，当耳套出现脏污或连续使用一个月时，请及时取下，用湿巾擦拭或用清水洗净晾干，防止细菌滋生。
- 如果您出现瘙痒、发红或其他刺激性反应，建议您立即暂停使用并清洁耳机，观察您的不适症状是否能自然恢复。如不适症状较明显，建议您咨询医生后决定是否继续佩戴耳机产品。